

Кафедра медицинской и биологической физики

**Тема: Основные понятия
медицинской электроники**

лекция № 6

**для студентов 1 курса, обучающихся по специальности
31.05.01 – Лечебное дело**

**к.п.н., доцент Шилина Н.Г.
Красноярск, 2020**

Цель лекции:

Ознакомить обучающихся с

1. Основными этапами получения медико-биологической информации.
2. Вопросами безопасности и надежности медицинской аппаратуры

План

- 1. Классификации медицинской техники.
Структурная блок-схема приборов для
регистрации биопотенциалов**
- 2. Электроды и датчики**
- 3. Усилители и генераторы**
- 4. Регистрирующие устройства**
- 5. Надежность медицинской аппаратуры**

- **Технические устройства, используемые в медицине, называют обобщенным «медицинская техника».**




- **Большинство современных медицинских по назначению приборов конструктивно является физическими приборами.**


Классификация медицинской техники:

1. медицинские инструменты

Скальпель

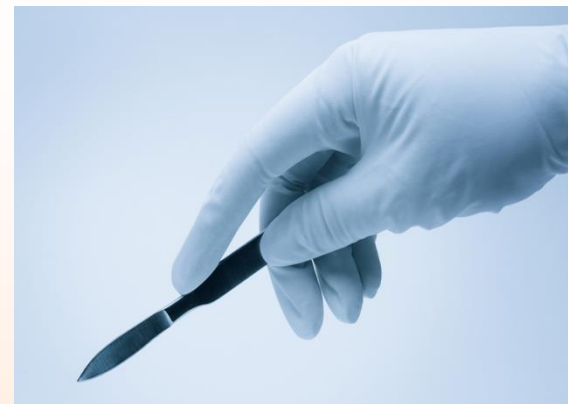

2. медицинское оборудование

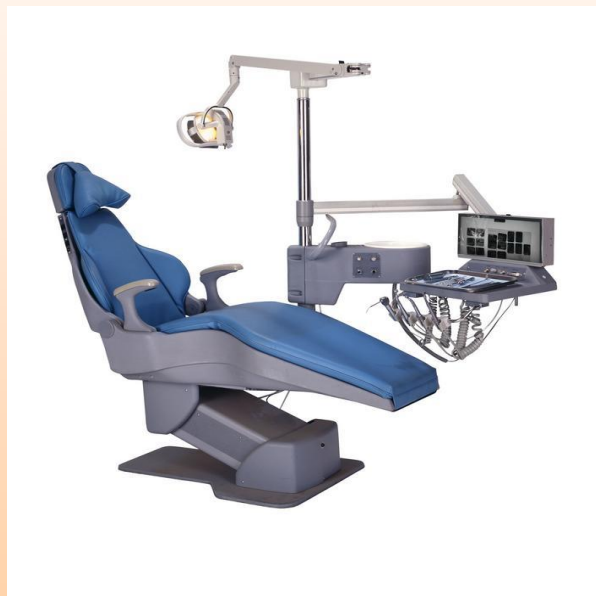

Стоматологическое
кресло



Рентгеновский аппарат

3. медицинская аппаратура

- **Медицинский инструмент действует на пациента в сочетании с рукой человека, являясь как бы ее продолжением.**
- **Медицинское оборудование — вспомогательные устройства для обслуживания пациента и обеспечения медицинского технологического (диагностического и лечебного) процесса.**

Медицинская аппаратура подразделяется на:

- медицинские приборы
- медицинские аппараты

Медицинский прибор — техническое устройство, предназначенное для диагностических или лечебных измерений (медицинский термометр, электрокардиограф и др.)

Электрокардиограф



Медицинские приборы можно разделить на:

- **воздействующие диагностические приборы**
- **воспринимающие диагностические приборы**

- **Воздействующие диагностические приборы**

дают необходимую информацию по реакции пациента на определенное воздействие (например, диагностические электростимуляторы), либо по внесенному телом пациента возмущению в поток энергии (рентгеновское просвечивание, ультразвуковая эхография и т.п.).

Аппарат УЗИ



Электростимулятор



- **Воспринимающие диагностические приборы** дают информацию о различных процессах в организме - генерируемых тканями и органами биопотенциалах, звуковых тонах сердца, температуре тела и др.
- **Воспринимающие диагностические приборы** должны оказывать минимальное влияние на исследуемый процесс и передавать информацию с наименьшими искажениями.

- При диагностике воздействующими приборами стремятся, как правило, снизить до минимально возможного уровня энергию воздействия, чтобы исключить побочные вредные для организма эффекты.

Медицинский аппарат – техническое устройство, позволяющее создавать энергетическое воздействие терапевтического, хирургического или бактерицидного свойства.



Аппарат УВЧ

Аппаратура обеспечивает в той или иной степени самостоятельный, автоматизированный процесс взаимодействия с пациентом.

Медицинская аппаратура наиболее сложная, интенсивно развивающаяся область медицинской техники.

Большую часть медицинской аппаратуры составляют **электроmedizinские приборы и аппараты**, представляющие собой электротехнические или электронные устройства.

Существует аппаратура, использующая механическую энергию:

1. твердого тела — аппараты для вытяжения костей, для механотерапии и др.,



Аппарат Елизарова

Существует аппаратура, использующая механическую энергию:

2. жидкости — водолечебные установки,



Существует аппаратура, использующая механическую энергию:

3. газа – наркозные аппараты, аппараты для искусственной вентиляции легких и др.



Наркозный аппарат

По функциональному признаку, т.е. в зависимости от целей, для которых она используется, электро­медицинская аппаратура разделена на:


- 1. терапевтическую**
- 2. диагностическую.**

Изделия терапевтической аппаратуры принято называть **аппаратами**,

Изделия диагностической аппаратуры – **приборами** .

- В зависимости от направления потока энергии в системе аппаратура-пациент, электрофизиологическую аппаратуру можно разделить на две части:
- **воздействующая**
- **воспринимающая**


- **Терапевтические аппараты** воздействуют на пациента с целью вызвать желаемые сдвиги в его организме — перестройку патологического процесса в сторону нормализации.
- **Хирургические аппараты**, являющиеся частью терапевтических, предназначены для осуществления радикальных изменений в структуре органов и тканей.

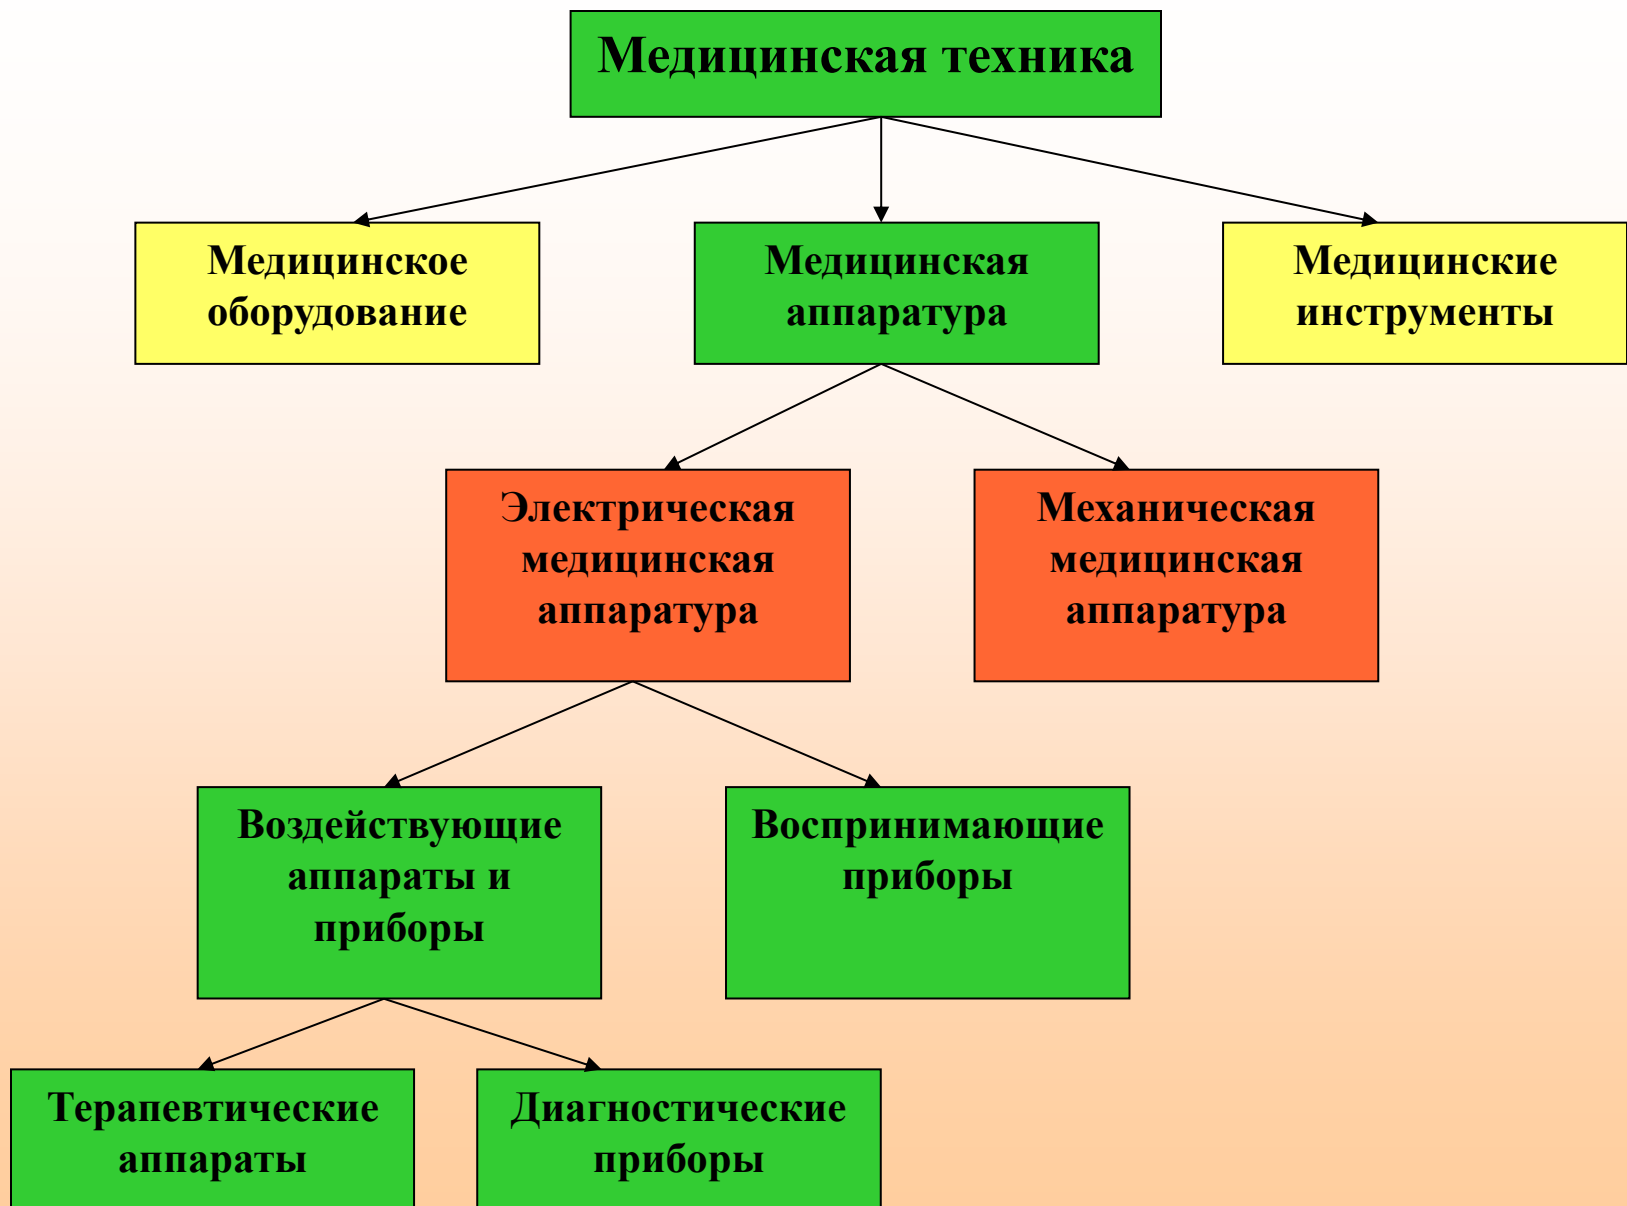


Основные группы приборов и аппаратов, используемые для медико-биологических целей:

- *Устройство для получения (съема), передачи и регистрации медико-биологической информации.* Большинство этих устройств содержит в своей схеме **усилитель** электрических сигналов.
- *Устройство, обеспечивающее дозирующее воздействие на организм различными физическими факторами с целью лечения.* С физической точки зрения эти устройства являются генераторами различных электрических сигналов.
- *Кибернетические электронные устройства.*

Структурная схема съема, передачи и регистрации медико-биологической информации

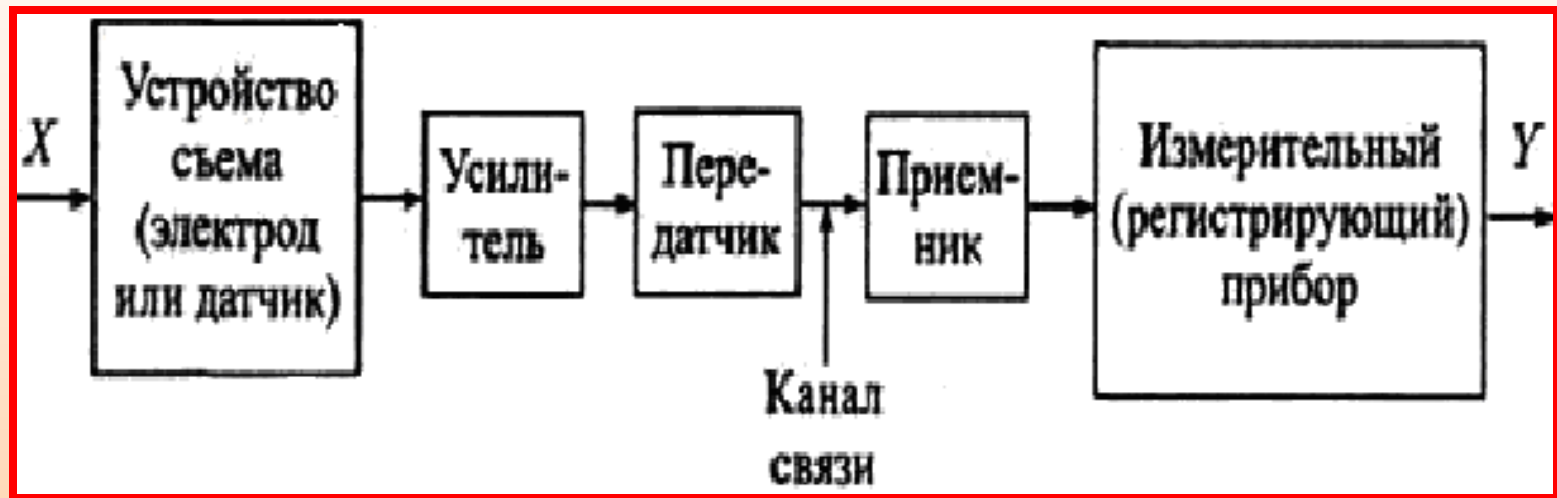

где X — измеряемый параметр биологической системы,
 Y — величина, регистрируемая на выходе измерительным прибором

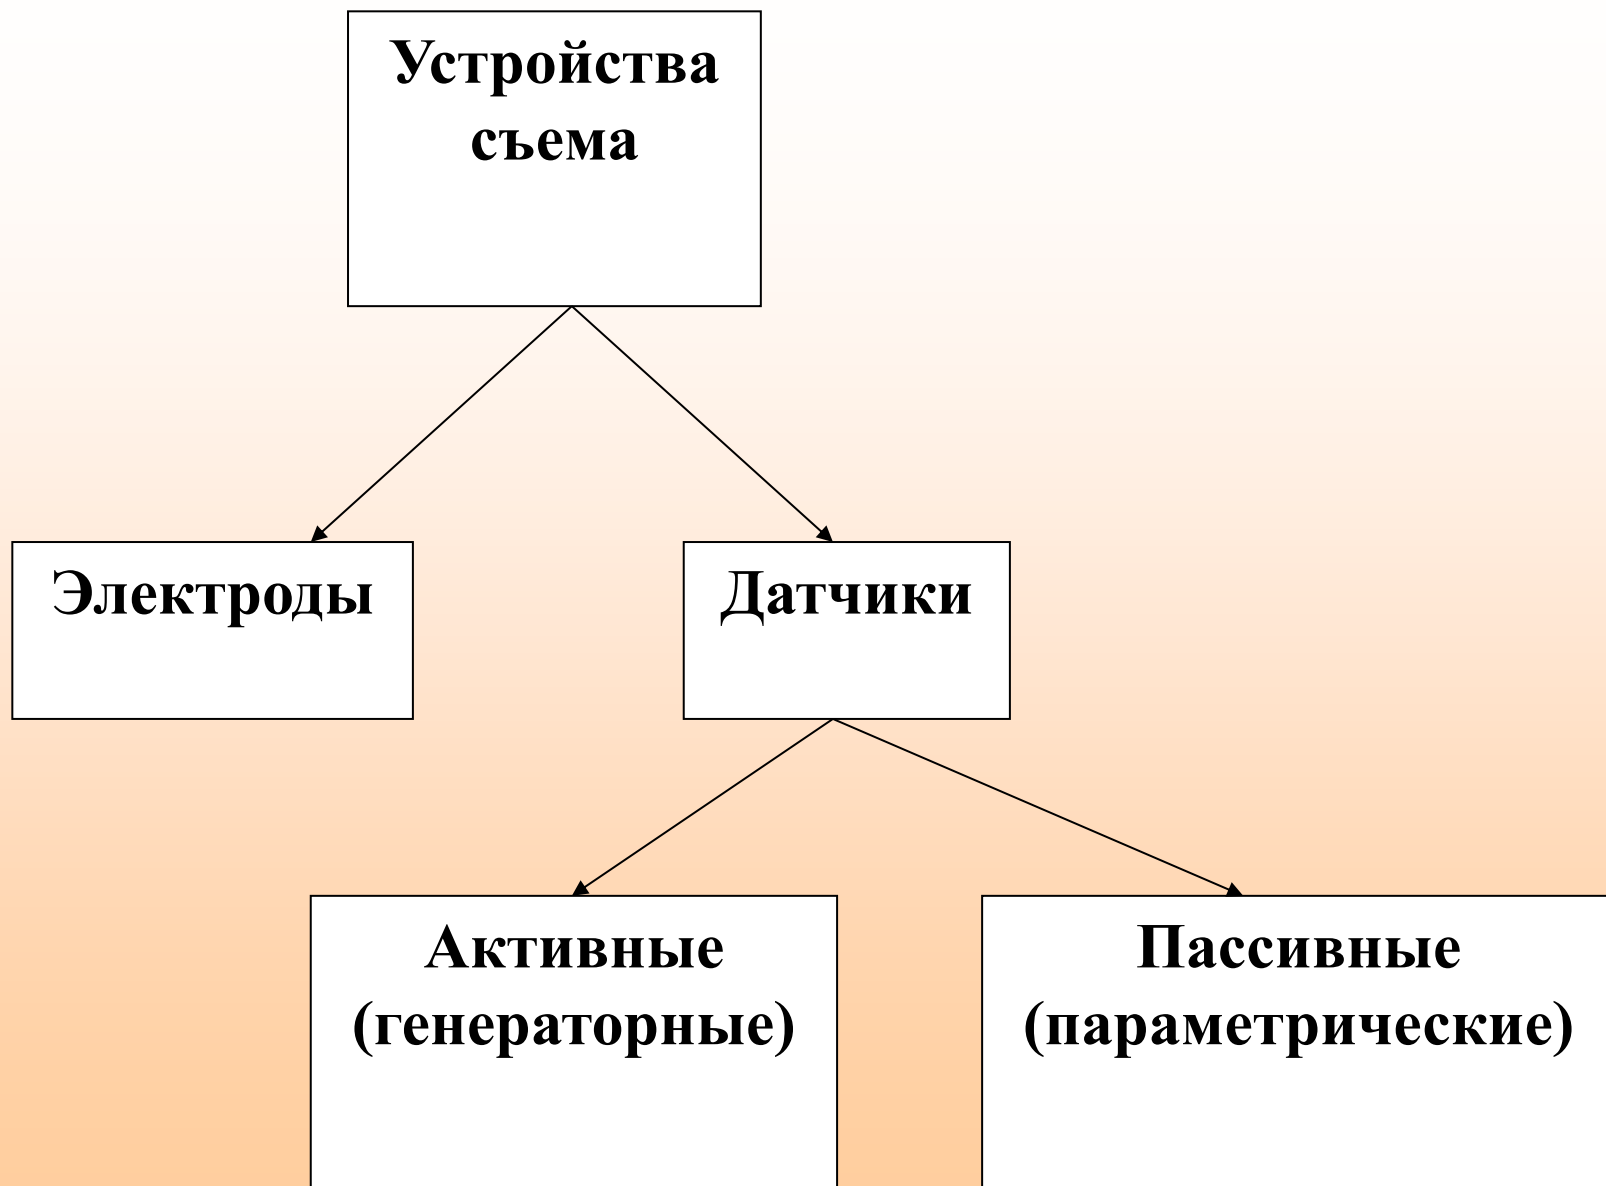


2. Принцип действия электродов

Электроды — это проводники специальной формы, соединяющие измерительную цепь с биологической системой.

К электродам предъявляются **требования**:

- они должны быстро фиксироваться и сниматься,
- иметь высокую стабильность электрических параметров,
- не искажать сигнал,
- не раздражать биологическую ткань и т. п.

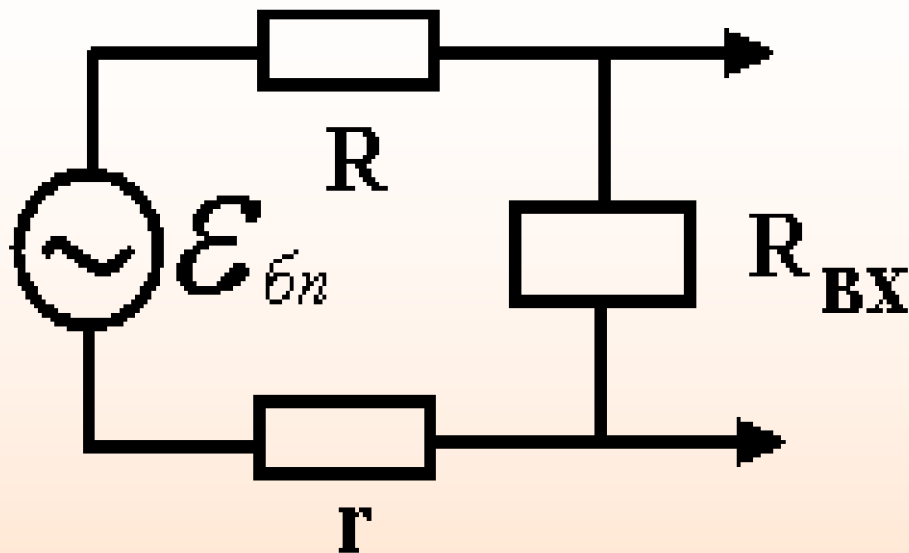

Эквивалентная схема снятия биопотенциалов

$\varepsilon_{\text{бп}}$ — ЭДС источника биопотенциалов;

r — сопротивление внутренних органов;

R — сопротивление кожи и электродов;

$R_{\text{вх}}$ — входное сопротивление усилителя.

Для уменьшения сопротивления контакта «электрод-кожа» можно :

- использовать салфетки, смоченные физраствором;
- увеличить площадь электрода (истинная картина в этом случае может искажаться, так как электрод будет захватывать сразу несколько эквипотенциальных поверхностей).


Проблемы:

1. возникновение гальванической ЭДС в месте контакта электрода с биологической системой.
2. электролитическая поляризация электродов, что приводит к выделению на электродах продуктов реакции при прохождении тока. В результате возникает встречная (по отношению к основной) ЭДС.

В обоих случаях возникновение ЭДС **искажает** снимаемый электродами **полезный** биоэлектрический сигнал.

Виды электродов при физиотерапии


Плоские электроды. Такие электроды используются, например, при гальванизации, электрофорезе. К телу больного подводят постоянный ток с помощью двух электродов, каждый из которых состоит из свинцовой пластинки (или токопроводящей углеграфитовой ткани) и гидрофильной прокладки.

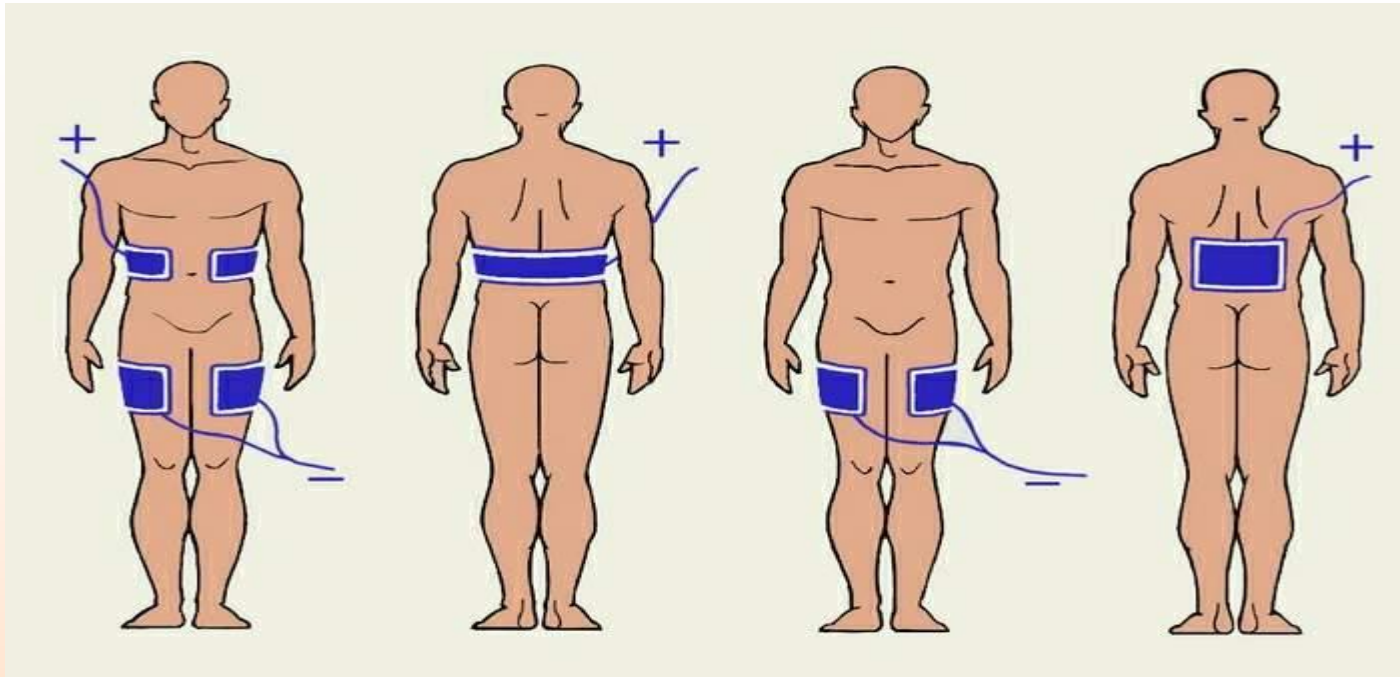

. Расположение плоских электродов при гальванизации

При **продольном** расположении электродов (на одной стороне тела) воздействию подвергаются поверхностно расположенные ткани. При **поперечном** расположении электродов (на противоположных участках тела) воздействию подвергаются глубоко расположенные органы и ткани.

Вакуумные электроды. Такие электроды используются в дарсонвализации. Воздух внутри стеклянных электродов баллонов имеет низкое давление (6,7-13,5 Па).

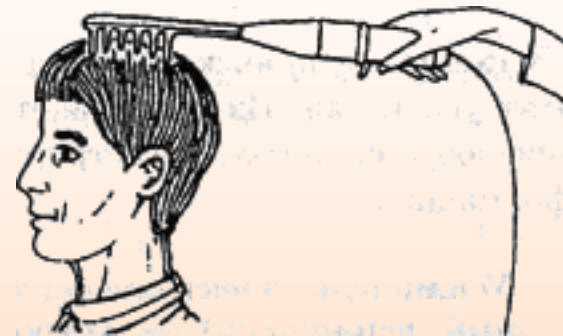

Стеклянные вакуумные электроды (а), использование электродов при лечении волосистой части головы (б)

При **контактной методике** (непрерывный контакт электрода с кожей) действующим фактором является среднечастотный электрический ток.

При **дистанционной методике** (электрод удален от кожи) действующим фактором является искровой разряд. При обеих методиках вакуумные электроды перемещаются относительно кожи.

Датчики медико-биологической информации

Датчик — устройство, преобразующее измеряемую или контролируемую величину в сигнал, удобный для передачи и регистрации. Преобразуемая величина X называется входной, а измеряемый сигнал α — выходной величиной.

Характеристика датчика — функциональная зависимость выходной величины α от входной X (описывается аналитически или графически).

Обычно стремятся иметь датчик с линейной характеристикой $\alpha = kX$, где k — постоянный коэффициент.

Чувствительность датчика S — отношение изменения выходной величины к соответствующему изменению входной величины:

$$S = \Delta\alpha / \Delta X.$$

Предел датчика — максимальное значение входной величины, которое может быть воспринято датчиком без искажения и без повреждения датчика.

Порог датчика — минимальное изменение входной величины, которое можно обнаружить датчиком.

Классы датчиков:

генераторные и параметрические.

Генераторные датчики — такие, которые под воздействием входного сигнала генерируют напряжение или ток (индукционные, пьезоэлектрические, фотоэлектрические и т.п.).


Параметрические датчики — такие, в которых под воздействием входного сигнала изменяется какой-либо параметр (тензометрические, емкостные, индуктивные, реостатные и т.п.).

Различают механические, акустические, температурные, оптические и другие датчики.


Параметрические датчики:

емкостные состоят из конденсатора,

индуктивные содержат катушку индуктивности.

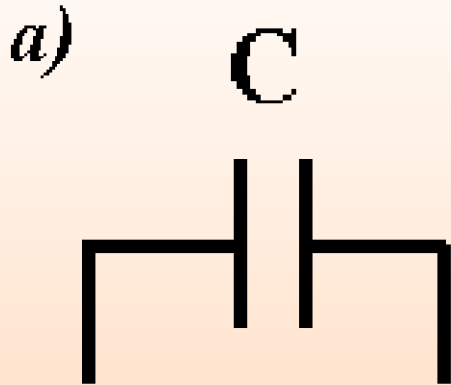

$$C = \frac{\epsilon \epsilon_0 S}{d}$$

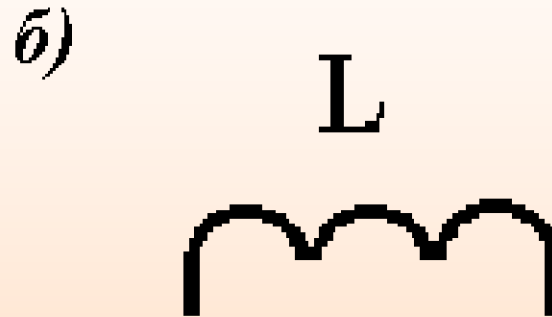


$$L = \frac{k_1 \mu n^2 \pi r^2}{l}$$


Емкость C плоского конденсатора (а) и индуктивность L катушки индуктивности (б)



Ультразвуковые датчики

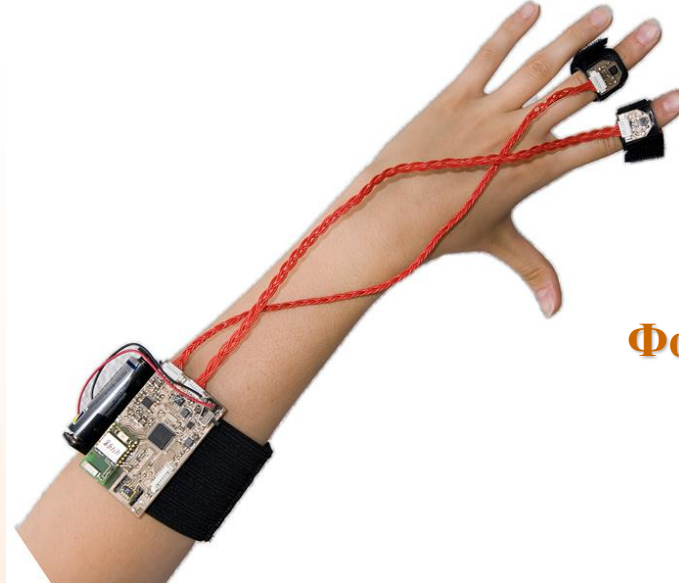

Фотодатчики

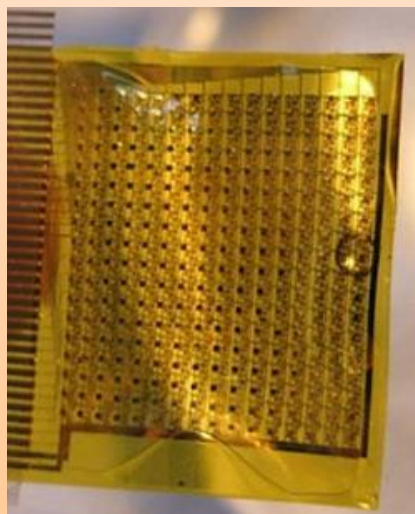

**Гибкие датчики
для сердца**



Синхронизирующий датчик

Дтчики давления

3. Усилитель

Усилитель электрических сигналов (*электронный усилитель*) — устройство, увеличивающее **амплитуду** этих сигналов без изменения их формы за счет постороннего источника электрической энергии.

Усилители могут создаваться на основе различных элементов (транзисторы, триоды и др.), однако в общих чертах их можно представить одинаково. Они имеют **вход**, на который подается усиливаемый электрический сигнал, и **выход**, с которого снимается усиленный сигнал (рис. 6).


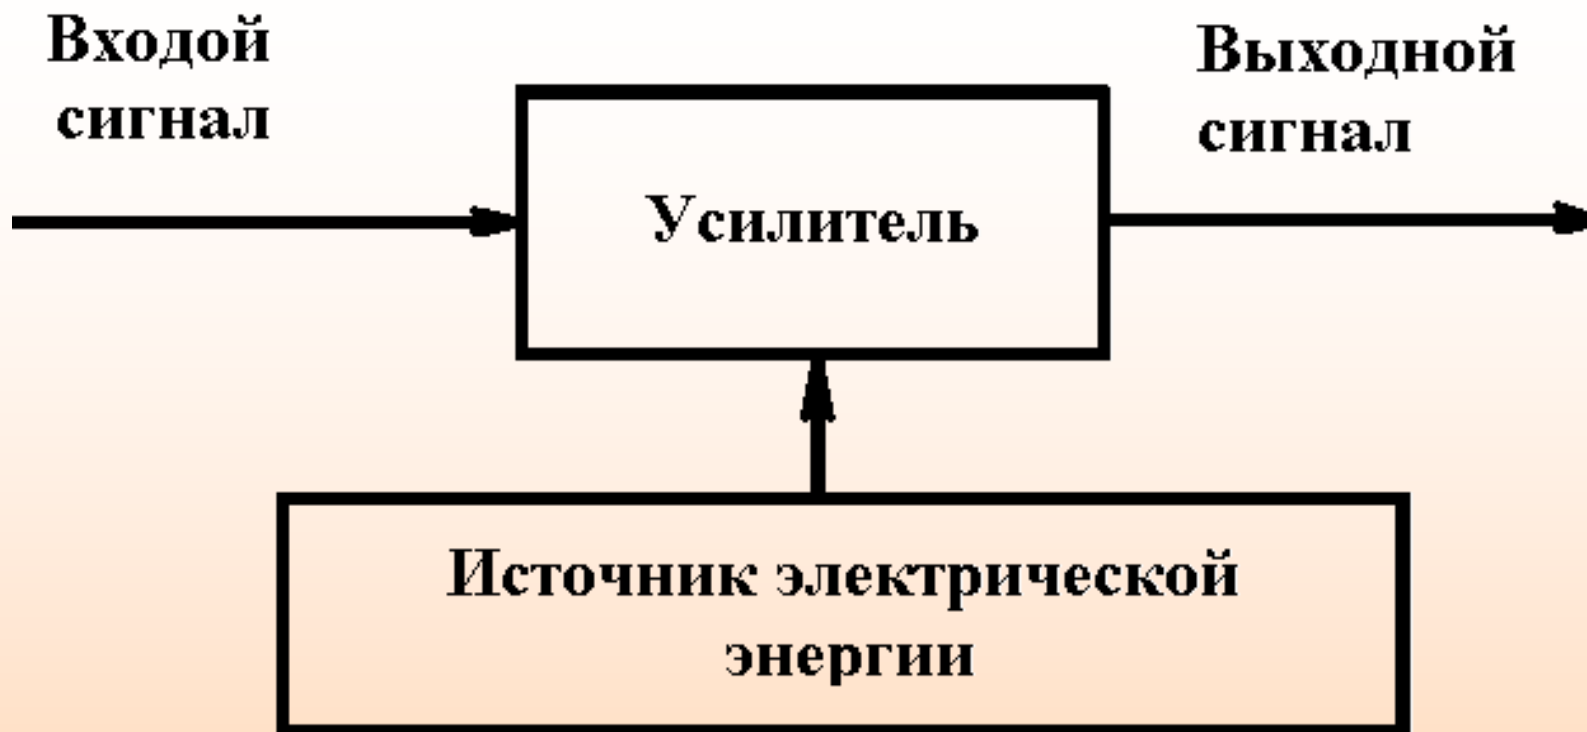


Схема усиления сигнала


В зависимости от целей усилители классифицируются по

- напряжению,
- силе тока,
- мощности.

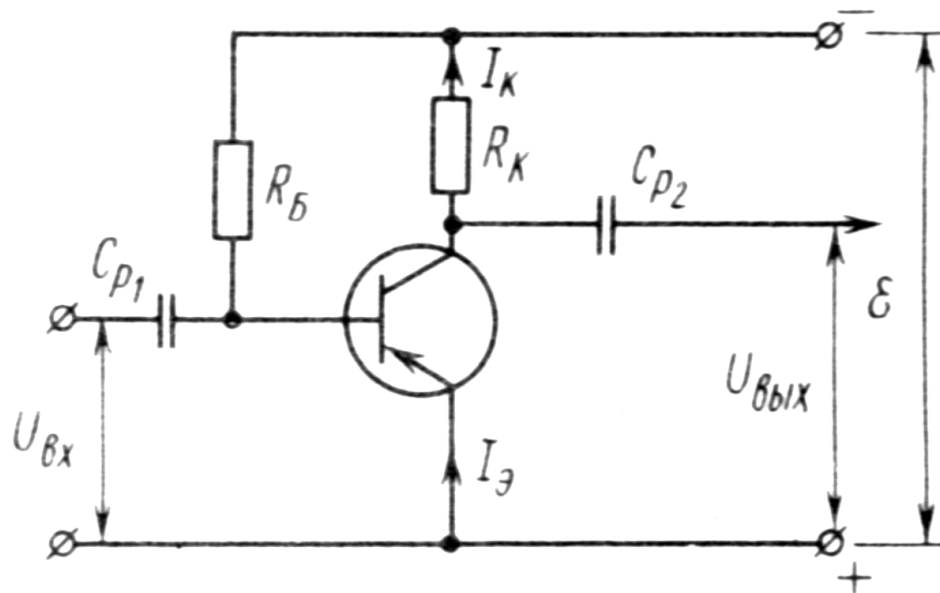

Усилитель однокаскадный

Усилитель многокаскадный

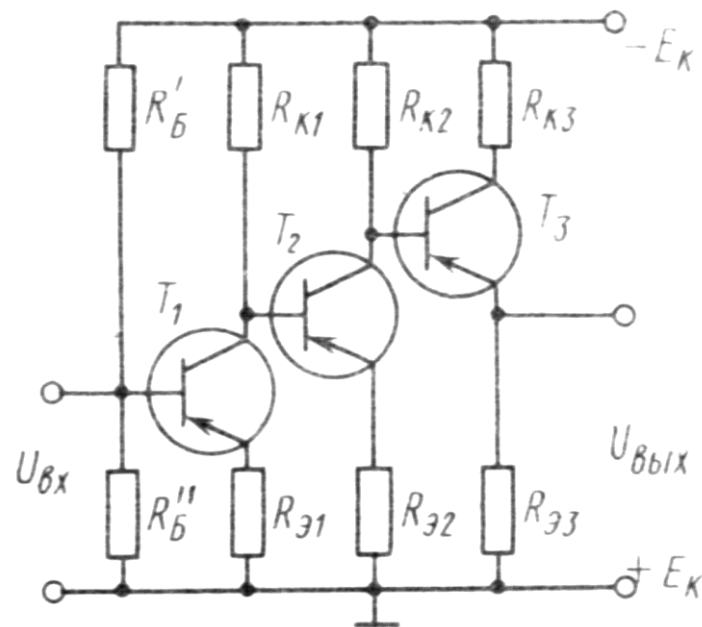

Характеристики усилителя

а) Входное сопротивление. $R_{\text{ВХ}}$ —

сопротивление между его входными клеммами, которое можно найти по формуле

$$R_{\text{ВХ}} = U_{\text{ВХ}} / I_{\text{ВХ}}$$

б) Коэффициент усиления.

Коэффициент усиления усилителя равен отношению сигнала на выходе усилителя к значению сигнала на входе:

$$K = U_{\text{ВЫХ}} / U_{\text{ВХ}}$$

Коэффициент усиления усилителя из нескольких каскадов равен произведению коэффициентов усиления усилителей всех используемых каскадов:

$$K_{\text{ОБЩ}} = K_1 K_2 K_3 \dots$$



в) Амплитудная характеристика усилителя — это зависимость максимального значения выходного сигнала от максимального значения входного.

Для рассматриваемого усилителя по напряжению амплитудная характеристика представляется зависимостью $U_{\text{МАХ Вых}} = f(U_{\text{МАХ Вх}})$.

Для неизменности формы сигнала коэффициент усиления должен быть одинаков в пределах изменения входного сигнала.

Для этого необходимо использовать усилитель с **линейной** амплитудной зависимостью:

$$U_{\text{MAX Вых}} = K \cdot U_{\text{MAX Вх}} \cdot$$

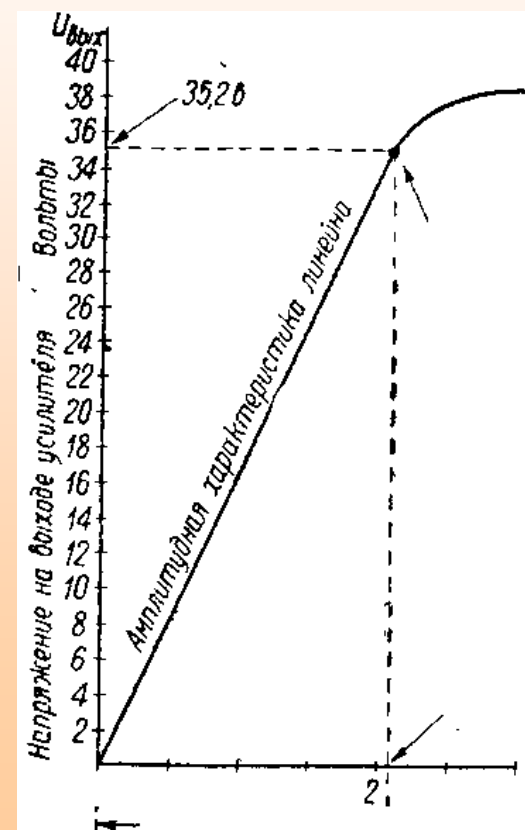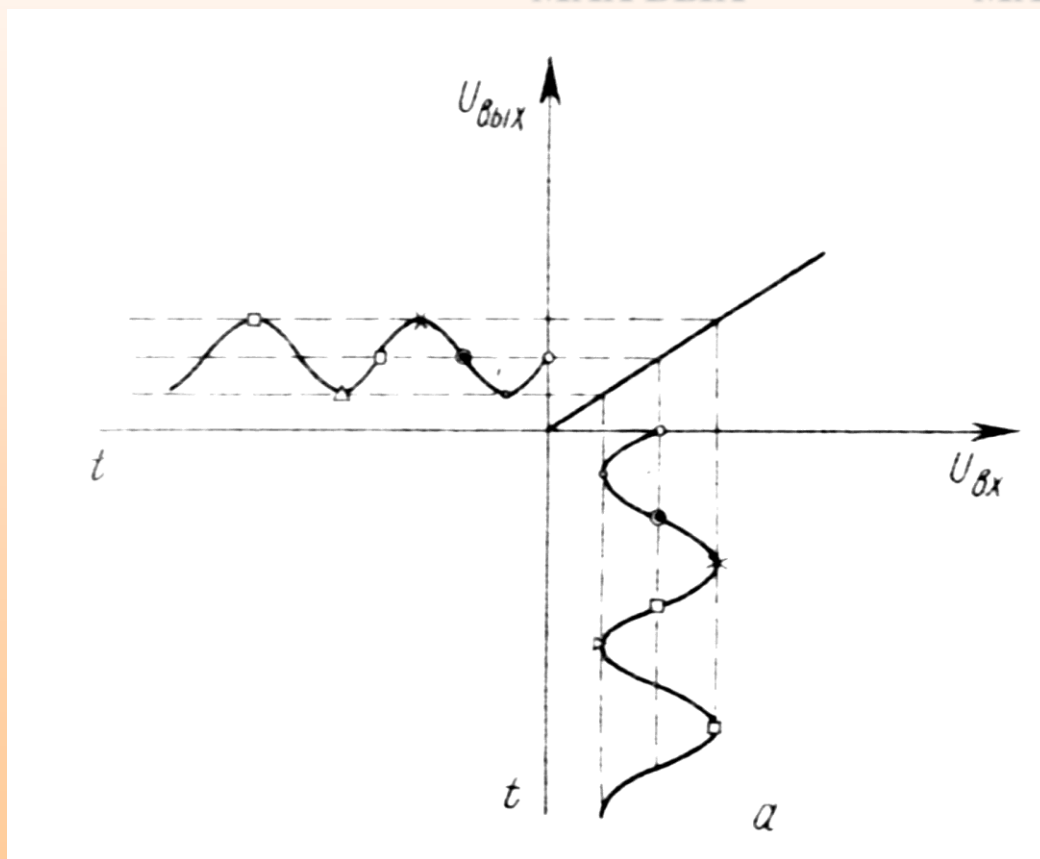



Амплитудная характеристика усилителя

2) **Частотная характеристика.** В том случае, когда усиливаемый сигнал несинусоидальный, его можно разложить на отдельные гармоники, характеризующиеся соответствующей частотой. Коэффициент усиления для каждой гармоники может оказаться разным. Поэтому необходимо учитывать частотную характеристику усилителя.

Частотная характеристика усилителя — это зависимость коэффициента усиления от частоты сигнала: $K = f(\nu)$.

Для того чтобы несинусоидальный сигнал был усилен без искажения, нужно, чтобы коэффициент усиления не зависел от частоты, то есть $K(\nu) = \text{const}$. В общем случае это условие не выполняется, что приводит к искажениям формы сигнала, которые называются **частотными**.

$$0,7 K_{\max} \approx \frac{K_{\max}}{\sqrt{2}}$$

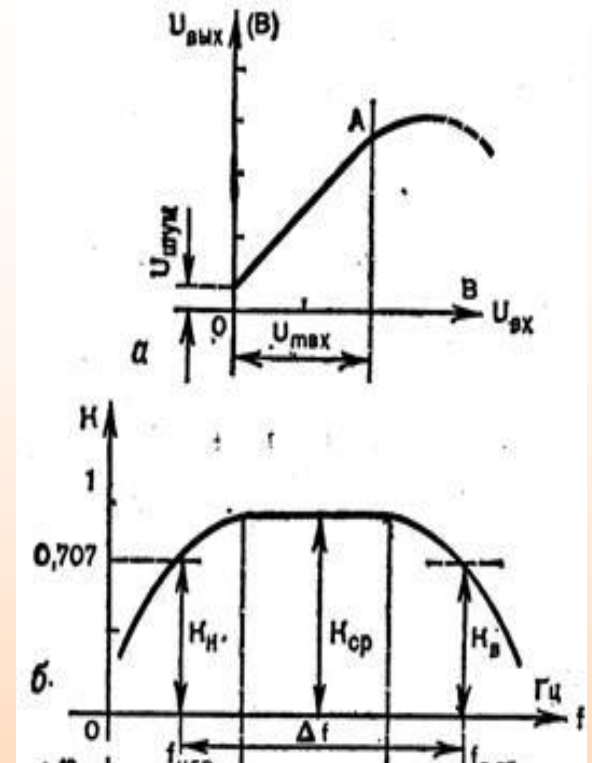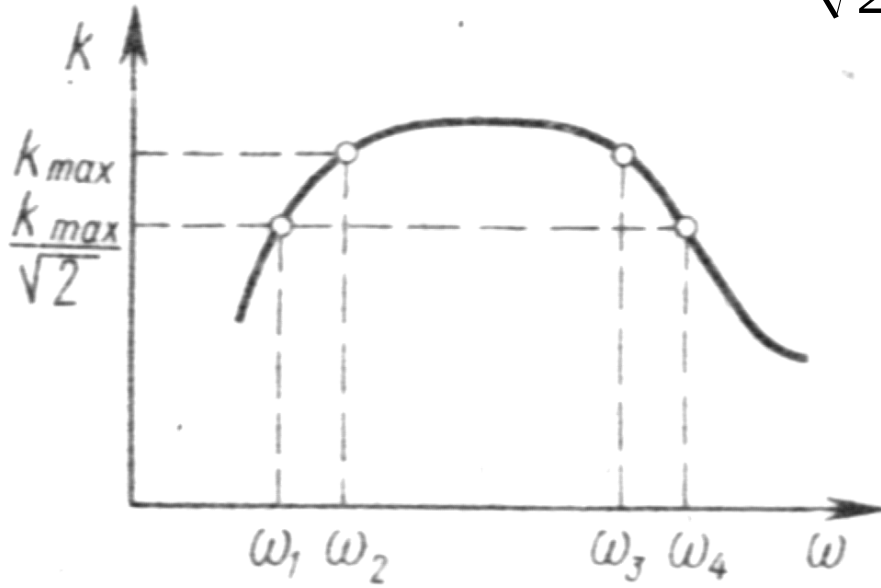

Частотная характеристика усилителя

Полосой пропускания усилителя называется интервал частот, в котором коэффициент усиления постоянен.

Особенности усиления биоэлектрических сигналов

Специфика усилителей биопотенциалов определяется *особенностями биопотенциалов:*

- выходное сопротивление биологической системы совместно с сопротивлением электродов, как правило, высокое;
- биопотенциалы — медленно изменяющиеся сигналы;
- биопотенциалы — слабые сигналы.

Особенности биоусилителей:

- Коэффициент усиления составляет $10^6 - 10^8$;
- Коэффициент дискриминации $10^5 - 10^6$;
- Все биоусилители – низкочастотные;
- Высокое входное и низкое выходное сопротивления.

Электростимуляторы, генераторы

Генераторы — устройства, которые преобразуют энергию источников постоянного напряжения в энергию электромагнитных колебаний различной формы.

Классификация генераторов:

- по форме сигнала: генератор гармонических колебаний и генератор колебаний специальной формы (импульсные колебания);
- по частоте сигналов;
- по мощности;
- по принципу работы (генератор с самовозбуждением и генератор с внешним возбуждением).

Генераторы *гармонических колебаний* работают на транзисторах или трехэлектродных лампах. Общие принципы функционирования их основаны на принципах работы автоколебательных систем.


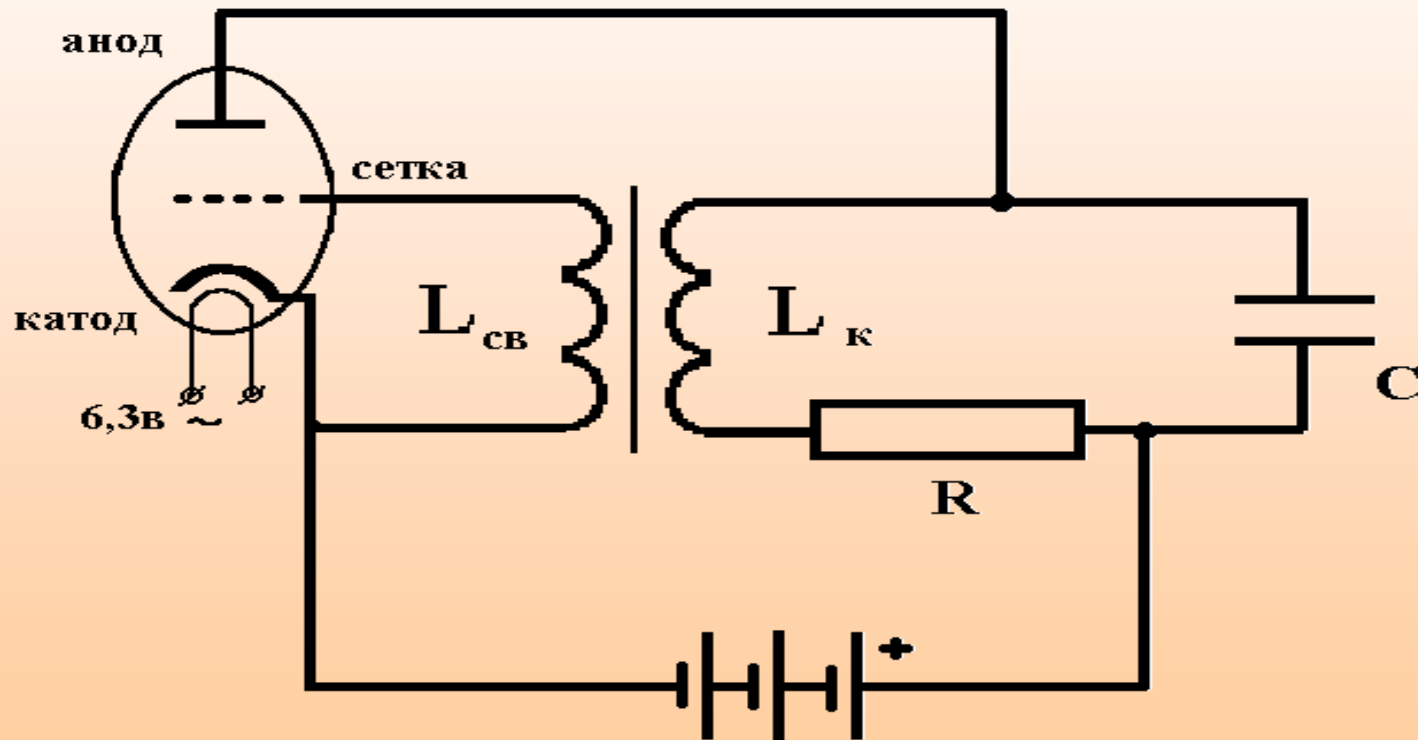


Схема генератора гармонических колебаний.

Релаксационные колебания — электромагнитные колебания несинусоидальной формы.

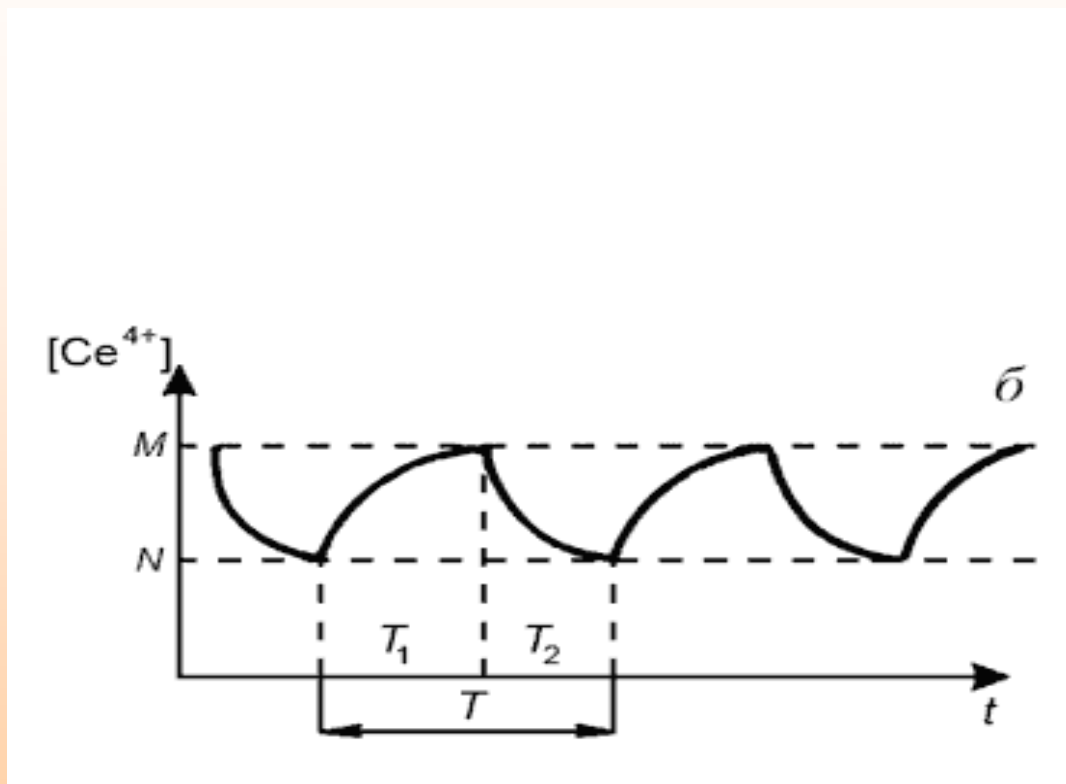

Пример релаксационных колебаний

Генераторы релаксационных колебаний
используются в: *амплипульстерапии,
флюктуоризации, аппарате «Электросон»,
диадинамотерапии, электростимуляции.*

Амплипульстерапия — генератор соответствующего аппарата создает синусоидальные токи на частоте 5000 Гц, модулированные по амплитуде низкой частотой в пределах 10-150 Гц (аппараты «Стимул»).

Флюктуоризация — генератор соответствующего аппарата создает синусоидальный ток малой силы и небольшого напряжения, беспорядочно меняющегося по амплитуде и частоте в пределах 100-2000 Гц. Использование таких токов уменьшает вероятность привыкания тканей к раздражителю (аппараты снятия боли — АСБ).

Электросон — генератор соответствующего аппарата создает импульсный ток низкой частоты и малой силы с импульсами прямоугольной формы (аппараты «Электросон»).

Диадинамотерапия — генератор соответствующего аппарата создает ток с импульсами полусинусоидальной формы (аппарат «Тонус»).

Электростимуляция — генератор соответствующего прибора создает импульсные токи (в частности, импульсы экспоненциальной формы) для восстановления функции нервно-мышечного аппарата человека (аппараты АСМ)



Аппарат для
амплипульстерапии



Аппарат Рефтон



Аппарат Электросон



Аппарат УВЧ

**Регистрирующие
устройства**

```
graph TD; A[Регистрирующие устройства] --> B[Аналоговые]; A --> C[Дискретные]; A --> D[Комбинированные];
```

Аналоговые

Дискретные

Комбинированные

Аналоговые

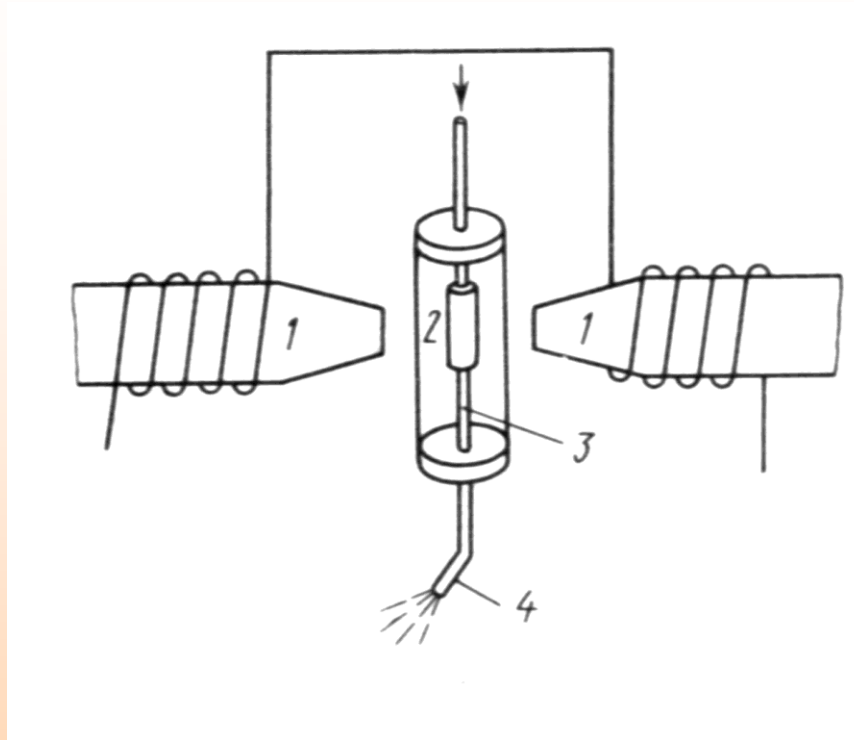


Рис.1. Схема струйного самописца

- 1 – электромагнит, через обмотки которого проходит регистрируемый биопотенциал;
2 – постоянный магнит; 3 – стеклянный капилляр;
4 – сопло капилляра.

- **Дискретные** — все виды счетчиков
- **Комбинированные** — электронно-лучевая трубка


НАДЕЖНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ

- **Надежность** — это способность изделия не отказывать в работе в заданных условиях эксплуатации и сохранять свою работоспособность в течение заданного интервала времени.
- **Вероятность безотказной работы** — это отношение числа $N(t)$ работающих (не испортившихся) за время t изделий к общему числу N_0 испытывавшихся изделий:

$$P(t) = \frac{N(t)}{N_0}$$

- **Интенсивность отказов** — это отношение числа отказов dN к произведению времени dt на общее число работающих элементов:

$$\lambda(t) = \frac{dN}{Ndt}$$

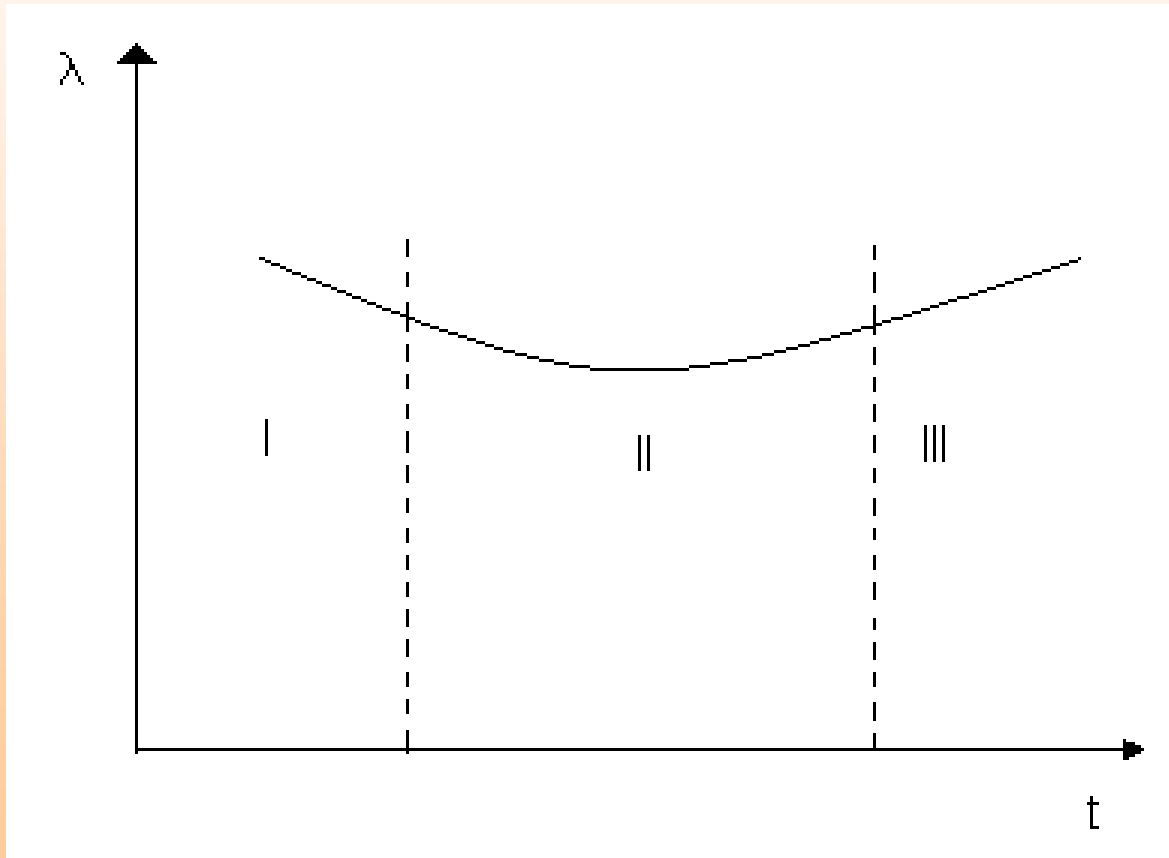

Классификация медицинской аппаратуры по возможным последствиям отказов в процессе эксплуатации

- **А** — изделия, отказ которых представляет непосредственную опасность для жизни пациента или персонала. Вероятность безотказной работы изделий этого класса должна быть не менее 0,99 между планово-предупредительными техническими обслуживаниями (ремонт, поверка). К изделиям класса А относятся приборы для наблюдения за жизненно важными функциями больного (аппараты искусственного дыхания, кровообращения и т.п.);

- **Б** — изделия, отказ которых вызывает искажения информации о состоянии больного или окружающей среды, не приводящее к непосредственной опасности для жизни пациента или персонала. Вероятность безотказной работы изделий этого класса должна быть не менее 0,8. К изделиям класса Б относятся системы, следящие за больным, аппараты для стимуляции сердечной деятельности и др.;
- **В** — изделия, отказ которых снижает эффективность или задерживает лечебно-диагностический процесс, либо повышает нагрузку на медицинский или обслуживающий персонал. К этому классу относится большая часть диагностической и физиотерапевтической аппаратуры, инструментов и др.
- **Г** — изделия, не содержащие отказоспособных частей.

Заключение:

Рассмотрены:

1. Основные этапы получения медико-биологической информации и средства, необходимые для их реализации: устройства съема (электроды датчика), усилитель, регистрирующие устройства.
2. Вопросы безопасности и надежности медицинской аппаратуры

Тест-контроль:

Устройство, преобразующее измеряемую или контролируемую величину в сигнал, удобный для передачи, дальнейшего преобразования и регистрации, называется:

- 1.датчиком
- 2.электродом
- 3.генератором
- 4.усилителем.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Обязательная:

1. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика: учебник. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.-

Дополнительная:

1. Федорова В.Н., Е. В. Фаустов. Краткий курс медицинской и биологической физики с элементами реабилитологии: учебное пособие. -М.:ГЭОТАР-Медиа,2010 .-
2. Антонов В.Ф., А. М. Черныш, Е. К. Козлова [и др.] Физика и биофизика. Курс лекций: учебное пособие.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.-
3. Ремизов А.Н., Максина А.Г. Сборник задач по медицинской и биологической физике: учеб. пособие для вузов. М. : Дрофа, 2010.
4. Руководство к лабораторным работам по медицинской и биологической физике для самост. работы студентов /сост. О.Д. Барцева и др. Красноярск: Литера-принт, 2009.-
5. Сборник задач по медицинской и биологической физике: учебное пособие для самост. работы студентов / сост. О.П.Квашнина и др. -Красноярск: тип.КрасГМА, 2007.-
6. Физика. Физические методы исследования в биологии и медицине: метод. указания к внеаудит. работе студентов по спец. – педиатрия / сост. О.П.Квашнина и др. -Красноярск: тип.КрасГМУ, 2009.-

Электронные ресурсы:

1. ЭБС КрасГМУ
2. Ресурсы интернет
3. Эдельман Е.Д. Физика с элементами биофизики. [Электронный ресурс] : учебник. - Режим доступа: <http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425244.html>



Красноярский
Государственный
Медицинский
Университет
им. проф.
В.Ф.Войно-Ясенецкого



**БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ**